

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-2700
Датум: 27.03.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 25.03.2014.г. упућен електронским путем, у вези јавне набавке мале вредности бр.05/2014 – Набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад једног ултразвучног апарата за Одсек вантелесне оплодње Службе гинекологије Опште болнице Ваљево.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављено питање:

У вези са Прилогом бр.8 Техничка спецификација, а који је део конкурсне документације, молимо

Наручиоца да нам додатно појасни следеће тачке исте:

Тачка 1. Описује апарат као : Digitalni kolor doppler ултразвучни апарат, а у тачки 4.

Начин приказа (модови рада) kolor doppler мод није наведен.


Наше питање је да ли Наручилац захтева да апарат има колор доплер мод рада?

Тачка 23. Захтева могућност надоградње stress eho protokolom, Tissue Doppler Imagingom, Panoramic View protokolom, Trapezoid Scan protokolom.

С обзиром да су све горе наведене надоградње, сем Panoramic View протокола, део ехокардиографске дијагностике, молимо Наручиоца да одговори да ли то значи да апарат мора поседовати могућност континуираног dopplera (CW doppler), кардиолошког програма и ЕКГ модула, а који су неопходан услов за све наведене надоградње, или апарат треба да има накнадну могућност надоградње континуираног доплера (CW doppler), кардиолошког програма и ЕКГ модула?

Такође напомињемо, пошто је евидентно по избору пакета мерења (тачка 20) и сонди, да се апарат набавља за Службу гинекологије, да Наручилац наводи могућност надоградњи на већи број кардиолошких протокола, а не спомиње могућност надоградње на 3D-4D ултразвучну дијагностику, а што је најчешће захтевана надоградња за гинеколошке ултразвучне апарате.

Одговор: У Прилогу бр.8-Техничка спецификација, у табели са минималним техничким захтевима под тачком 1. назначено је: „Digitalni kolor dopler ultrazvučni aparat“, самим тим значи да апарат има дигитални колор доплер начин приказа (мод рада).

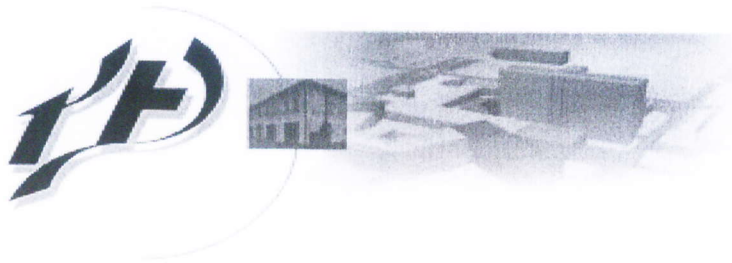

Наручилац Прилогом бр.8 наводи који су то минималне техничке карактеристике које понуђени апарат треба да поседује. Под тачком 23. јасно је наведено да апарат мора да има **могућност надоградње минимум** stress echo protokolom, Tissue Doppler Imagingom, Panoramic View protokolom, Trapezoid Scan protokolom, што подразумева да понуђени апарат не мора да поседује наведене надоградње већ да постоји могућност да се накнадно надогради наведеним протоколима.



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку